


Measuring range / Messbereich / Domaine de mesure / Intervalo de medida:

2 – 200 mg/l (de) Cl⁻ with 1 full pipette / mit 1 Pipettenfüllung / avec 1 volume de pipette / con 1 carga de pipeta
Graduation / Abstufung / Graduation / Graduación 2 mg/l (de) Cl⁻

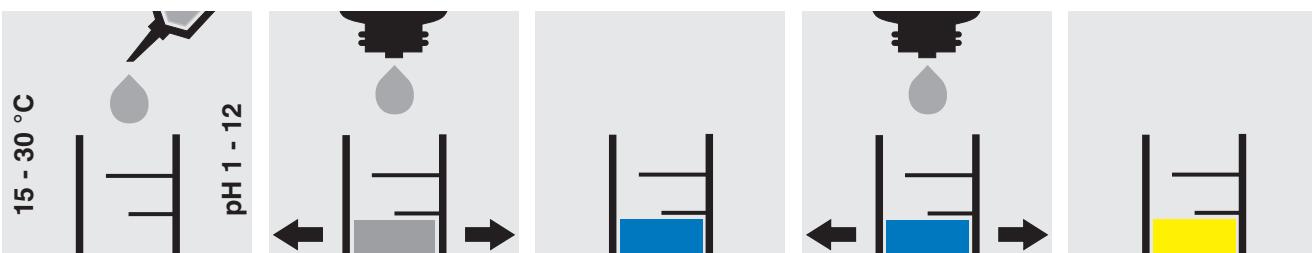

5 ml of sample

Add 2 drops of reagent
CI-1 and swirl.

Color of the solution:
blue

Add reagent **CI-2** drop-
wise while swirling until
the color changes to
yellow.

Color of the solution:
yellow

5 ml Probe

2 Tropfen Reagenz
CI-1 zugeben und um-
schwenken.

Farbe der Lösung:
Blau

Unter Umschwenken
Reagenz **CI-2** zutropfen
bis zum Farbumschlag
nach **Gelb**.

Farbe der Lösung:
Gelb

5 ml d'échantillon

Ajouter 2 gouttes de ré-
actif **CI-1** et agiter légi-
rement.

Couleur de la solution:
bleue

Ajouter le réactif **CI-2**,
goutte à goutte et en
agitant légèrement,
jusqu'au virage de la
couleur au **jaune**.

Couleur de la solution:
jaune



5 ml de muestra

Añadir 2 gotas de reac-
tivo **CI-1** y agitar por ba-
lanceo.

Color de la solución:
azul

Agitando por balanceo,
añadir el reactivo **CI-2**
gota a gota hasta viraje
a **amarillo**.

Color de la solución:
amarillo



Fill the dropping tube of
the titration pipette with
reagent **CI-3**.

Slowly add reagent **CI-3**
dropwise to the sample
while swirling until its
Color changes from **yel-**
low to **blue-violet**.

Read off the result in
mg/l from the scale of
the titration pipette.

Tropfrohr der Titrierpi-
pette mit Reagenz **CI-3**
füllen.

Reagenz **CI-3 langsam**
und unter Umschwen-
ken zur Probe tropfen,
bis deren Farbe von
Gelb nach **Blauviolett**
umschlägt.

Messwert in mg/l auf der
Skala der Titrierpipette
ablesen.

Remplir le tube compte-
gouttes de la pipette de
titrage avec du réactif
CI-3.

Ajouter **lentement**, goutte
à goutte **et en agitant**
légerement, le réactif
CI-3 à l'échantillon
jusqu'à ce que sa cou-
leur vire du **jaune** au
bleu violet.

Lire le résultat en mg/l
sur l'échelle de la pi-
pette de titrage.

Llenar el tubo cuentago-
tas de la pipeta de va-
loración con reactivo
CI-3.

Lentamente y agitando
por balanceo, gotear el
reactivo **CI-3** a la mues-
tra, hasta que su color
vire de **amarillo** a **vio-
ta azulada**.

Leer el valor de medi-
ción en mg/l en la esca-
la de la pipeta de valo-
ración.